Системный подход
для решения задач клинико-диагностической лаборатории

Диакон

КАТАЛОГ

- *Системы и принадлежности для взятия крови*
- *Лабораторная пластиковая посуда*
- *Принадлежности для микробиологии*
- *Дозаторы*

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы, используемые при изготовлении продукции _____ 4

Вакуумные пробирки Ampulab для взятия крови _____ 5

Иглы и держатели для вакуумных пробирок _____ 12

Пробирки для взятия капиллярной крови _____ 13

Пробирки с реагентами без вакуума для взятия венозной крови _ 14

Пробирки для анализа мочи _____ 18

Одноразовые лабораторные пробирки _____ 19

Микропробирки, кюветы, капсулы для анализаторов _____ 26

Планшеты _____ 27

Контейнеры для биоматериалов _____ 28

Счетные пластинки _____ 31

К-слайды со средами _____ 32

Тупферы, пробирки с тупферами, транспортные среды _____ 33

Чашки петри _____ 35

Микробиологические петли, пипетки пастера _____ 36

Механические дозаторы _____ 37

Штативы для дозаторов _____ 42

Наконечники для дозаторов _____ 43

АО «ДИАКОН» предлагает продукцию высочайшего качества от лучших мировых производителей:

Компания SoyaGreenTec, Корея – производство вакуумных систем с торговой маркой AMPULAB для взятия крови.
АО «ДИАКОН» – эксклюзивный дистрибьютор в РФ.

Компания Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD., Китай – производство пробирок для капиллярной крови и лабораторной посуды.
АО «ДИАКОН» – официальный дистрибьютор в РФ.

Компания MEUS, Италия – производство невакуумных пробирок для взятия крови, одноразовой пластиковой посуды и принадлежностей для бактериологии.
АО «ДИАКОН» – эксклюзивный дистрибьютор в РФ.

Компания ROLL, Италия – производство одноразовой пластиковой посуды и принадлежностей для бактериологии.
АО «ДИАКОН» – эксклюзивный дистрибьютор в РФ.

Компания Литопласт-Мед, Беларусь – производство одноразовой пластиковой посуды и принадлежностей для бактериологии.
АО «ДИАКОН» – официальный дистрибьютор в РФ.

Компания DRAGONLAB, Китай – производство дозаторов мирового качества..
АО «ДИАКОН» – официальный дистрибьютор в РФ.

Вся предлагаемая продукция зарегистрирована в МЗ РФ. Качество продукции соответствует стандартам CE, ISO 9001, ISO 13485.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ

Полипропилен / Polypropylene (ПП)

Полупрозрачный, матовый термопластик, получаемый, путём полимеризации пропилена. Прочный и гибкий материал, устойчив к влаге, маслам и растворителям.
Выдерживает температуру до +130°C.

Полистирол / Polystyrene (ПС)

Твёрдый полимер, прозрачный, продукт полимеризации стирола; растворим в ароматических и галогенированных углеводородных соединениях.
Выдерживает температуру от –20°C до +70°C.

Полиметилметакрилат / PMMA (ПММК)

Термопластик, полимер метилметакрилата. Влагоустойчивый твёрдый материал с прекрасными оптическими свойствами. По свойствам наиболее близок к стеклу.
Выдерживает температуру от –20°C до +65/95°C.

Полиэтилен / Polyethylene (ПЭ)

Термопластик, получаемый путём полимеризации этилена при повышенных температуре и давлении в присутствии катализаторов. В производстве медицинского оборудования используется для изготовления пробок и пипеток Пастера. Выдерживает температуру от –50°C до +105°C.

Полиэтилентерефталат / PET (ПЭТ)

Прозрачный пластик с очень хорошими механическими свойствами и отличным заграждающим эффектом. Особенно подходит для производства вакуумных пробирок.
Выдерживает температуру до +80°C.

ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ AMPULAB ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Абсолютная безопасность для персонала, так как отсутствует контакт с кровью пациента.

Значительное снижение количества преаналитических ошибок:

- простота использования;
- надежность маркировки;
  - этикетки на пробирках на русском языке;
  - возможен заказ пробирок с прозрачными этикетками, что даёт возможность контроля правильного заполнения пробирки кровью даже если перед взятием крови на пробирку была наклеена дополнительная этикетка ЛПУ, например со штрих-кодом;
- снижение риска гемолиза образцов;
- исключение этапов приобретения, разведения и дозирования антикоагулянтов;
- цветные колпачки пробирок для удобства выбора пробирки с необходимым наполнителем.

Стабильно высокое качество материалов и реагентов:

- высокоточная технология напыления добавок;
- размеры и материалы всех частей пробирок стандартизованы и адаптированы под современные автоматические лабораторные станции и приборы;
- радиационная стерилизация;
- разделительный гель не влияет на результаты при исследовании гормонов и лекарственном мониторинге;
- пробирки с двойными стенками для исследования системы гемостаза;
- отсутствие отклонений от оптимальной концентрации вакуума до окончания срока годности;
- полный автоматизированный контроль всех стадий производства.

Снижение и (или) избавление от затрат:

- на приобретение и приготовление антикоагулянтов;
- на мойку, обеззараживание, стерилизацию;
- на повторные проведения анализов из-за некачественных материалов или преаналитических ошибок.

Производит благоприятное впечатление на пациента:

- быстрота взятия крови;
- возможность взятия крови в несколько пробирок без повторных венепункций;
- использование современных методов.

ПРАВИЛА ВЕНЕПУНКЦИИ

1. Приготовьте все необходимые для взятия крови материалы и снимите защитный колпачок с короткой части иглы.



2. Закрепите иглу в иглодержателе.

3. Продезинфицируйте место венепункции, снимите защитный колпачок с длинной части иглы и введите иглу в вену пациента.



4. Вставьте пробирку в держатель так, чтобы игла проткнула пробку пробирки. Как только появится ток крови, ослабьте (снимите) жгут на руке пациента

5. Аккуратно извлеките пробирку из держателя после её заполнения и, при необходимости, вставьте следующую. Иглодержатель при этом должен быть надежно зафиксирован, чтобы игла не вышла из вены.



6. После заполнения последней пробирки извлеките иглу с держателем из вены и обработайте место венепункции.



Важно:

- Все манипуляции должны выполняться в перчатках.
- После заполнения пробирок кровью их необходимо аккуратно перевернуть примерно 8 раз для лучшего перемешивания крови с добавками и поставить в штатив.
- После завершения процедуры взятия крови иглы должны быть утилизированы в контейнер для острых отходов.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОБИРОК

При необходимости взятия крови в несколько пробирок, рекомендуется следующая последовательность их заполнения:

1. Пробирки для получения сыворотки с активатором свёртывания крови

2. Пробирки для коагулологии с цитратом натрия

3. Пробирки для исследования сыворотки с активатором свертывания и гелем

4. Пробирки для исследований плазмы

5. Пробирки для гематологических исследований

6. Пробирки для исследований глюкозы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЮ

Перед центрифугированием пробирок для получения сыворотки сгусток должен быть полностью сформированным. В пробирках для сыворотки с красной крышкой для этого требуется от 60 минут, для пробирок с гелем достаточно 30 минут.

Следуйте указаниям из таблицы по силе и времени центрифугирования

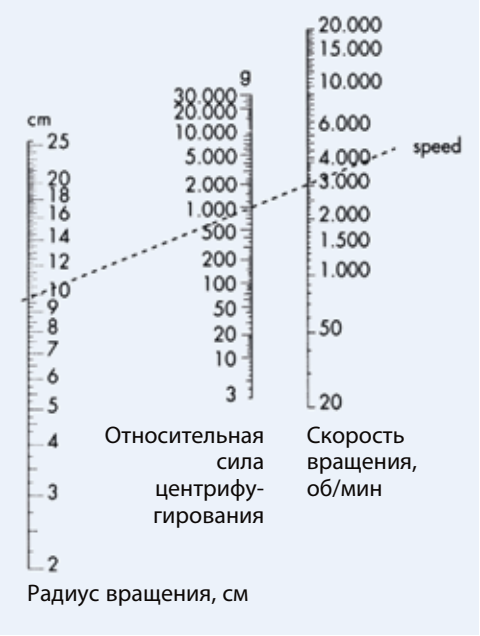

Вид пробирок			ОСЦ (G)	Время, мин
Пробирки AMPULAB	Сыворотка	простые	1500 ~ 1600	10
		с гелем	1800 ~ 2000	10
	Плазма	Антикоагулянты без геля	2000 ~ 2500	15
		с гелем	2200 ~ 2300	15

Реологические свойства барьерного материала зависят от температуры. Из-за охлаждения перед центрифугированием или во время центрифугирования текучесть может быть затруднена. Для оптимизации текучести и предотвращения нагрева во время центрифугирования настройте охлаждаемую центрифугу на 25°C. Пробирки с гелем должны быть центрифугированы не позднее двух часов после взятия крови. После формирования барьера пробирки не должны центрифугироваться повторно.

Относительная сила центрифугирования зависит от радиуса и скорости вращения центрифуги. Она определяется по формуле:

$G = 1{,}11 \times 10^{-5} \times R \times S^2$, где G – относительная сила центрифугирования; R – радиус ротора центрифуги в см, S – число оборотов в минуту.

Относительную силу центрифугирования можно также определить по номограмме.

ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ AMPULAB ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ

Soyagreentec, Корея

- ***Вакуумные пробирки с активатором свёртывания крови для исследования сыворотки в клинической химии, иммунологии, серологии***

Кат. №	Наполнитель, описание цвет крышки	Этикетка	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
104101	Активатор свёртывания (кремнезём) Крышка красная	бумажная	4,0	13×75	100 / 1000
104101 T		прозрачная	4,0	13×75	100 / 1000
106201		бумажная	6,0	13×100	100 / 1000
106201 T		прозрачная	6,0	13×100	100 / 1000
100301		бумажная	10,0	16×100	100 / 1000
100301 T		прозрачная	10,0	16×100	100 / 1000
103102	Гель + активатор свёртывания. Сохранение сыворотки до 48 ч, снижение риска гемолиза Крышка желтая	бумажная	3,5	13×75	100 / 1000
103102 T		прозрачная	3,5	13×75	100 / 1000
105202		бумажная	5,0	13×100	100 / 1000
105202 T		прозрачная	5,0	13×100	100 / 1000
108302		бумажная	8,5	16×100	100 / 1000
108302 T		прозрачная	8,5	16×100	100 / 1000

- ***Вакуумные пробирки с цитратом натрия для исследования коагуляции***

Кат. №	Наполнитель, описание цвет крышки	Этикетка	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
301105	Цитрат натрия 3,2% (0,109M) 1:9 Крышка голубая	бумажная	1,8	13 x 75	100 / 1000
301105 T		прозрачная	1,8	13 x 75	100 / 1000
302105		бумажная	2,7	13 x 75	100 / 1000
302105 T		прозрачная	2,7	13 x 75	100 / 1000
304205		бумажная	4,5	13 x 100	100 / 1000
304205 T		прозрачная	4,5	13 x 100	100 / 1000
301112	Цитрат натрия 3,8% (0,129M) 1:9 Крышка голубая	бумажная	1,8	13 x 75	100 / 1000
301112 T		прозрачная	1,8	13 x 75	100 / 1000
302112		бумажная	2,7	13 x 75	100 / 1000
302112 T		прозрачная	2,7	13 x 75	100 / 1000
304212		бумажная	4,5	13 x 100	100 / 1000
304212 T		прозрачная	4,5	13 x 100	100 / 1000

• *Вакуумные пробирки для исследований цельной крови в гематологии и иммунологии*

Кат. №	Наполнитель, описание цвет крышки	Этикетка	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
202103	K_2-ЭДТА Крышка фиолетовая (сиреневая)	бумажная	2,0	13 x 75	100 / 1000
202103 T		прозрачная	2,0	13 x 75	100 / 1000
203103		бумажная	3,0	13 x 75	100 / 1000
203103 T		прозрачная	3,0	13 x 75	100 / 1000
204103		бумажная	4,0	13 x 75	100 / 1000
204103 T		прозрачная	4,0	13 x 75	100 / 1000
206203		бумажная	6,0	13 x 100	100 / 1000
206203 T		прозрачная	6,0	13 x 100	100 / 1000
200303		бумажная	10,0	16 x 100	100 / 1000
200303 T		прозрачная	10,0	16 x 100	100 / 1000
202104	K_3-ЭДТА Крышка фиолетовая (сиреневая)	бумажная	2,0	13 x 75	100 / 1000
202104 T		прозрачная	2,0	13 x 75	100 / 1000
203104		бумажная	3,0	13 x 75	100 / 1000
203104 T		прозрачная	3,0	13 x 75	100 / 1000
204104		бумажная	4,0	13 x 75	100 / 1000
204104 T		прозрачная	4,0	13 x 75	100 / 1000
206204		бумажная	6,0	13 x 100	100 / 1000
206204 T		прозрачная	6,0	13 x 100	100 / 1000
200304		бумажная	10,0	16 x 100	100 / 1000
200304 T		прозрачная	10,0	16 x 100	100 / 1000

• *Вакуумные пробирки для исследований плазмы в молекулярной биологии, ПЦР, иммунологии*

Кат. №	Наполнитель, описание цвет крышки	Этикетка	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
703111	K_2-ЭДТА + разделительный гель Крышка фиолетовая (сиреневая)	бумажная	3,5	13 x 75	100 / 1000
703111 T		прозрачная	3,5	13 x 75	100 / 1000
705214		бумажная	5,0	13 x 100	100 / 1000
705214 T		прозрачная	5,0	13 x 100	100 / 1000
708311		бумажная	8,5	16 x 100	100 / 1000
708311 T		прозрачная	8,5	16 x 100	100 / 1000

- ***Вакуумные пробирки для исследований плазмы и клеток крови в клинической химии и иммунологии***

Кат. №	Наполнитель, описание цвет крышки	Этикетка	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
404106	Li-гепарин Крышка зелёная	бумажная	4,0	13 x 75	100 / 1000
404106 T		прозрачная	4,0	13 x 75	100 / 1000
406206		бумажная	6,0	13 x 100	100 / 1000
406206 T		прозрачная	6,0	13 x 100	100 / 1000
400306		бумажная	10,0	16 x 100	100 / 1000
400306 T		прозрачная	10,0	16 x 100	100 / 1000
404107	Li-гепарин Крышка зелёная	бумажная	4,0	13 x 75	100 / 1000
404107 T		прозрачная	4,0	13 x 75	100 / 1000
406207		бумажная	6,0	13 x 100	100 / 1000
406207 T		прозрачная	6,0	13 x 100	100 / 1000
400307		бумажная	10,0	16 x 100	100 / 1000
400307 T		прозрачная	10,0	16 x 100	100 / 1000
403108	Li-гепарин + разделительный гель Крышка зелёная	бумажная	3,0	13 x 75	100 / 1000
403108 T		прозрачная	3,0	13 x 75	100 / 1000
404208		бумажная	4,5	13 x 100	100 / 1000
404208 T		прозрачная	4,5	13 x 100	100 / 1000
408308		бумажная	8,0	16 x 100	100 / 1000
408308 T		прозрачная	8,0	16 x 100	100 / 1000

• *Вакуумные пробирки для исследования глюкозы*

Кат. №	Наполнитель, описание цвет крышки	Этикетка	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
503109	NaF+оксалат К Крышка серая	бумажная	3,0	13 x 75	100 / 1000
503109 Т		прозрачная	3,5	13 x 75	100 / 1000

• *Вакуумные пробирки для исследования биологических жидкостей отличных от крови*

Кат. №	Наполнитель, описание цвет крышки	Этикетка	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
404106	Без наполнителей Крышка белая	бумажная	4,0	13 x 75	100 / 1000
404106 Т		прозрачная	4,0	13 x 75	100 / 1000
406206		бумажная	6,0	13 x 100	100 / 1000
406206 Т		прозрачная	6,0	13 x 100	100 / 1000
400306		бумажная	10,0	16 x 100	100 / 1000
400306 Т		прозрачная	10,0	16 x 100	100 / 1000

• *Вакуумные пробирки для определения СОЭ по методу Панченкова*

Кат. №	Наполнитель, описание цвет крышки	Этикетка	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
601111	Цитрат натрия 3,8% (0,129М) 1:4 Крышка черная	бумажная	1,6	13 x 75	100 / 1000
601111 Т		прозрачная	1,6	13 x 75	100 / 1000
602111		бумажная	2,4	13 x 75	100 / 1000
602111 Т		прозрачная	2,4	13 x 75	100 / 1000

ИГЛЫ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ПРОБИРОК

• *Иглы для вакуумных пробирок*

Кат. №	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
3020-K	Игла двусторонняя 20G 1”, жёлтая	0,9 x 25	100 / 3000
3020	Игла двусторонняя 20G 11/2”, жёлтая	0,9 x 38	100 / 3000
3020-V	Игла двусторонняя 20G 11/2”, жёлтая с визуальной камерой	0,9 x 38	50 / 1500
3021-K	Игла двусторонняя 21G 1”, зелёная	0,8 x 25	100 / 3000
3021	Игла двусторонняя 21G 11/2”, зелёная	0,8 x 38	100 / 3000
3021-V	Игла двусторонняя 21G 11/2”, зелёная с визуальной камерой	0,8 x 38	50 / 1500
3022-K	Игла двусторонняя 22G 1”, чёрная	0,7 x 25	100 / 3000
3022	Игла двусторонняя 22G 11/2”, чёрная	0,7 x 38	100 / 3000
3022-V	Игла двусторонняя 22G 11/2”, чёрная с визуальной камерой	0,7 x 38	50 / 1500

• *Держатели для вакуумных пробирок*

Кат. №	Описание	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
4001	Держатель стандартный	100
4002	Держатель с устройством для сброса иглы	100
4003	Держатель с защитным устройством (чехлом для иглы)	50

ПРОБИРКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ

Ningbo Greetmed, Китай

Кат. №	Описание	Объем, мкл	Кол-во шт. в уп. мин. / трансп.
GT210-0001-023	К3-ЭДТА	200	100 / 3000
GT210-0005-023	К3-ЭДТА, с капилляром	200	100 / 3000
GT210-0005-023-S	К3-ЭДТА, с капилляром, стерильные в индивидуальной упаковке	200	100 / 3000
GT210-0005-253	К3-ЭДТА, с капилляром	250	100 / 3000
GT210-0005-253-S	К3-ЭДТА, с капилляром, стерильные в индивидуальной упаковке	250	100 / 3000
GT210-0001-053	К3-ЭДТА	500	100 / 3000
GT210-0005-053	К3-ЭДТА, с капилляром	500	100 / 3000
GT210-0005-053-S	К3-ЭДТА, с капилляром, стерильные в индивидуальной упаковке	500	100 / 3000
GT210-0001-022	К2-ЭДТА	200	100 / 3000
GT210-0005-022	К2-ЭДТА, с капилляром	200	100 / 3000
GT210-0005-022-S	К2-ЭДТА, с капилляром, стерильные в индивидуальной упаковке	200	100 / 3000
GT210-0005-252	К2-ЭДТА, с капилляром	250	100 / 3000
GT210-0005-252-S	К2-ЭДТА, с капилляром, стерильные в индивидуальной упаковке	250	100 / 3000
GT210-0001-052	К2-ЭДТА	500	100 / 3000
GT210-0005-052	К2-ЭДТА, с капилляром	500	100 / 3000
GT210-0005-052-S	К2-ЭДТА, с капилляром, стерильные в индивидуальной упаковке	500	100 / 3000

ПРОБИРКИ С РЕАГЕНТАМИ БЕЗ ВАКУУМА ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ

Meus, Италия

- ***Пробирки без вакуума с активатором свёртывания крови для исследования сыворотки в клинической химии, иммунологии, серологии***

Кат. №	Наполнитель, описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт.
189327	Пробирки Sekurplast с активатором свёртывания Красная пробка	4,5	13×75	1000
183027		5,0	12×86	1000
1802417		8,0	16×75	1000
180027		10,0	16×100	1000
18218	Пробирки Sekurplast с активатором свёртывания и гранулами Sierosep Белая пробка	4,5	13×75	1000
18223		5,0	12×86	1000
18213		8,0	16×75	1000
18203		10,0	16×100	1000
18281	Пробирки Sekurplast с активатором свёртывания и гелем Sierogel. Сохранение сыворотки до 48 часов, снижение риска гемолиза Красная пробка	4,5	13×75	1000
18279		5,0	12×86	1000
18276		8,0	16×75	1000
18271		10,0	16×100	1000

Все пробирки для получения сыворотки стерилизованы радиацией и содержат активатор свертывания – инертные силиконовые частицы (SiO_2), нанесенные на внутренние стенки пробирки.

Кроме того, в пробирке могут находиться разделительные гранулы или разделительный гель.

Гранулы Sierosep – для получения сыворотки, используемой в клинической химии, – представляют собой инертные полистироловые частицы, вес которых меньше сгустка, но больше веса сыворотки. Во время центрифугирования гранулы поднимаются вверх и образуют барьер между сгустком крови и сывороткой, что обеспечивает лучшее и более четкое разделение сыворотки и сгустка.

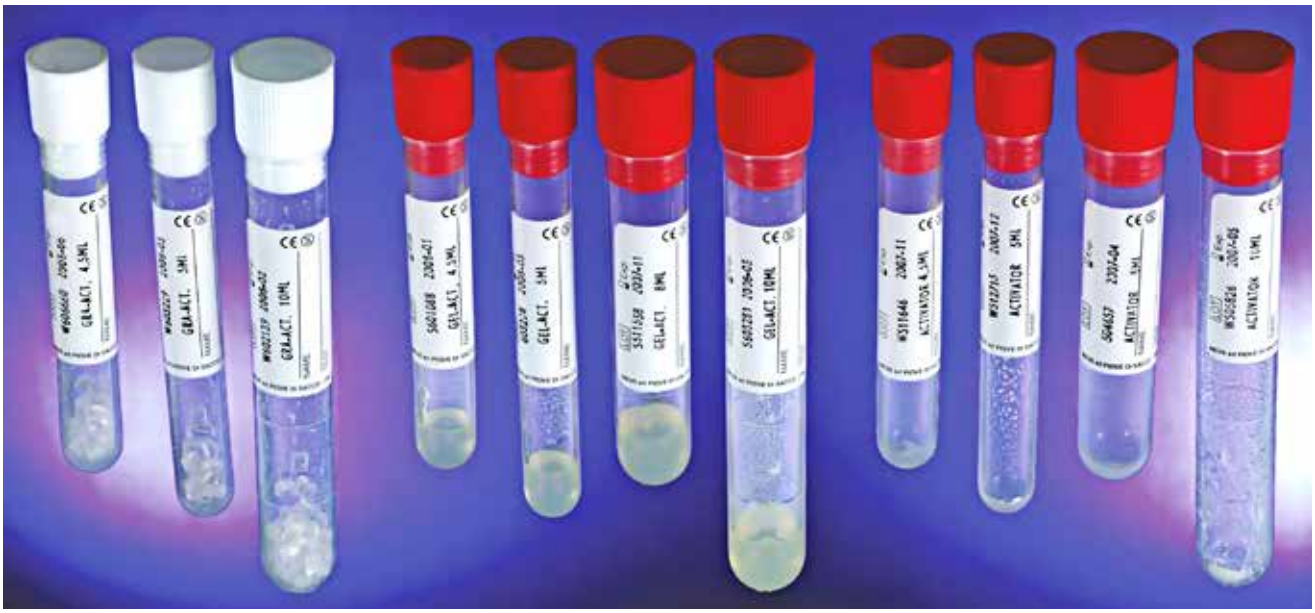

Гель Sierogel – для получения сыворотки, используемой в клинической химии. Гель представляет собой инертный полимер, вес которого меньше сгустка, но больше веса сыворотки. Во время центрифугирования гель поднимается вверх и образует барьер-пробку, что обеспечивает четкое разделение сыворотки и сгустка, и удерживает данное разделение до 48 часов без повторного центрифугирования.

- ***Пробирки без вакуума с ЭДТА для исследований цельной крови в гематологии и иммунологии***

Кат. №	Наполнитель, описание	Объем крови, мл	Размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт.
18540125	K_3-ЭДТА. Этикетка с отметкой "1 мл", плоское дно, зелёная пробка	1,0	12×56	1500
18553030	K_3-ЭДТА. Прокалываемая зелёная резиновая пробка, этикетка с отметкой "1,5 мл", круглое дно	1,5	13×75	1000
18540	K_3-ЭДТА, плоское дно, зелёная пробка	2,5	12×56	1500
18544	K_3-ЭДТА, круглое дно, зелёная пробка	2,5	12×86	1000
18543	K_3-ЭДТА, плоское дно, зелёная пробка	2,5	16×58	1500
18556	K_3-ЭДТА, круглое дно, зелёная пробка	3,0	13×75	1000
18553	K_3-ЭДТА. Прокалываемая зелёная резиновая пробка, этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно	3,0	13×75	1000
18557	K_3-ЭДТА. Прокалываемая фиолетовая резиновая пробка, этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно	3,0	13×75	1000
18559	K_3-ЭДТА. Прокалываемая белая резиновая пробка, этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно	3,0	13×75	1000
18547	K_3-ЭДТА. Плоское дно, зелёная пробка	5,0	16×58	1500
18548	K_3-ЭДТА. Круглое дно, зелёная пробка	5,0	12×86	1000
18552	K_3-ЭДТА. Круглое дно, зелёная пробка	5,0	16×100	1000
18520125	K_2-ЭДТА. Этикетка с отметкой "1 мл", плоское дно, светло-зелёная пробка	1,0	12×56	1500
18520	К2-ЭДТА. Плоское дно, светло-зелёная пробка	2,5	12×56	1500
18523	K_2-ЭДТА. Плоское дно, светло-зелёная пробка	2,5	16×58	1500
18524	K_2-ЭДТА. Круглое дно, светло-зелёная пробка	2,5	12×86	1000

• *Пробирки без вакуума с Li-гепарином для исследований плазмы и клеток крови в клинической химии и иммунологии*

Кат. №	Наполнитель, описание	Объем крови, мл	Размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт.
18640125	Li-гепарин.Этикетка с отметкой "1 мл", плоское дно, синяя пробка	1,0	12×56	1500
18640	Li-гепарин, плоское дно, синяя пробка	2,5	12×56	1500
18644	Li-гепарин, круглое дно, синяя пробка	2,5	12×86	1000
18643	Li-гепарин, плоское дно, синяя пробка	2,5	16×58	1500
18653	Li-гепарин, круглое дно, синяя пробка	3,0	13×75	1000
18647	Li-гепарин, плоское дно, синяя пробка	5,0	16×58	1500
18648	Li-гепарин, круглое дно, синяя пробка	5,0	12×86	1000
18650	Li-гепарин, круглое дно, синяя пробка	10,0	16×100	1000

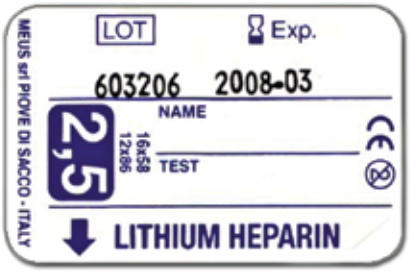

• *Пробирки без вакуума с цитратом натрия*

Кат. №	Наполнитель, описание	Объем крови, мл	Размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт.
18610125	Цитрат натрия 0,1 мл. Этикетка с отметкой "1 мл", плоское дно, розовая пробка	1,0	12×56	1500
18740	Цитрат натрия 0,1 мл. Этикетка с отметкой "1 мл", плоское дно, жёлтая пробка	1,0	12×56	1500
18608015	Цитрат натрия 0,15 мл. Этикетка с отметкой "1,5 мл", круглое дно, розовая пробка	1,5	13×75	1000
18609015	Цитрат натрия 0,15 мл. Прокалываемая розовая резиновая пробка, этикетка с отметкой "1,5 мл", круглое дно	1,5	13×75	1000
18730	Цитрат натрия 0,18 мл. Этикетка с отметкой "1,8 мл", плоское дно, жёлтая пробка	1,8	12×56	1500
18610	Цитрат натрия 0,25 мл. Плоское дно, розовая пробка	2,5	12×56	1500
18613	Цитрат натрия 0,25 мл. Плоское дно, розовая пробка	2,5	16×58	1500
18614	Цитрат натрия 0,25 мл. Круглое дно, розовая пробка	2,5	12×86	1000
18608	Цитрат натрия 0,3 мл. Этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно, розовая пробка	3,0	13×75	1000
18688	Цитрат натрия 0,3 мл. Этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно, жёлтая пробка	3,0	13×75	1000
18611	Цитрат натрия 0,3 мл. Прокалываемая зелёная резиновая пробка, этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно	3,0	13×75	1000
18609	Цитрат натрия 0,3 мл. Прокалываемая фиолетовая резиновая пробка, этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно	3,0	13×75	1000

Кат. №	Наполнитель, описание	Объем крови, мл	Размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт.
186091	Цитрат натрия 0,3 мл. Прокалываемая белая резиновая пробка, этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно	3,0	13×75	1000
18561	Цитрат натрия 0,5 мл. Плоское дно, жёлтая пробка	5,0	16×58	1500
18562	Цитрат натрия 0,5 мл. Круглое дно, жёлтая пробка	5,0	12×86	1000
18564	Цитрат натрия 0,5 мл. Круглое дно, жёлтая пробка	5,0	16×100	1000

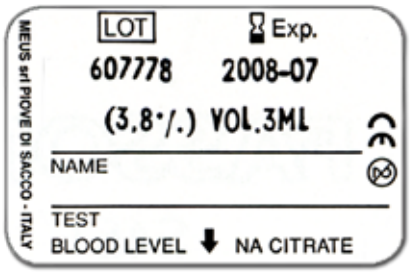

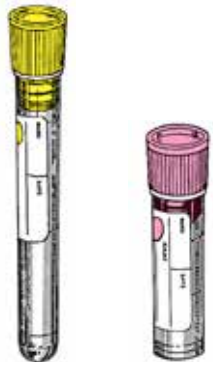

- ***Пробирки без вакуума для исследования глюкозы***

Кат. №	Наполнитель, описание	Объем крови, мл	Размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт.
18502	KF + Na_2-ЭДТА. Плоское дно, оранжевая пробка	2,5	12×56	1500
18505	KF + Na_2-ЭДТА. Плоское дно, оранжевая пробка	2,5	16×58	1500
18506	KF + Na_2-ЭДТА. Круглое дно, оранжевая пробка	2,5	12×86	1000
18515	KF + Na_2-ЭДТА. Круглое дно, оранжевая пробка	3,0	13×75	1000
18509	KF + Na_2-ЭДТА. Плоское дно, оранжевая пробка	5,0	16×58	1500
18510	KF + Na_2-ЭДТА. Круглое дно, оранжевая пробка	5,0	12×86	1000

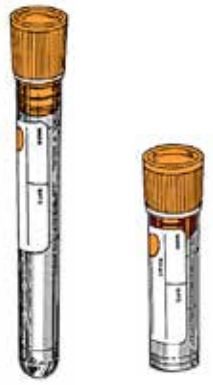

ПРОБИРКИ ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Произво-дитель
189937	Пробирка с консервантом (борная кислота), с жёлтой пробкой, прозрачная, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, 50 шт. в штативе, ПС	10	16×100	1000	Meus, Италия
183067	Пробирка с консервантом (борная кислота), с жёлтой пробкой, прозрачная, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, ПС	10	16×100	1500	Meus, Италия
18991	Пробирка с белой пробкой, прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5–10 мл, 50 шт. в штативе, ПС, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18993	Пробирка с белой пробкой, прозрачная, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, 50 шт. в штативе, ПС, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18980	Пробирка с белой пробкой, матовая, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5–10 мл, 50 шт. в штативе, ПП, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18995	Пробирка с белой пробкой, матовая, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, 50 шт. в штативе, ПП, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18980B	Пробирка с белой заниженной пробкой, матовая, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5–10 мл, 50 шт. в штативе, ПП, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18995B	Пробирка с белой заниженной пробкой, матовая, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, 50 шт. в штативе, ПП, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18010T	Пробирка с белой пробкой, прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5–10 мл, ПС, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18306T	Пробирка с белой пробкой, прозрачная, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, ПС, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18006T	Пробирка с белой пробкой, матовая, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5–10 мл, ПП, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18014T	Пробирка с белой пробкой, матовая, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, ПП, нестерильная	10	16×100	1000	Meus, Италия
18159	Пробирка, коническая, с расширенным горлышком, ПС, нестерильная	12	16×105	1500	Roll, Италия
18169	Пробирка, коническая, с расширенным горлышком, с выступом для седиментации, ПС, нестерильная	12	16×105	1500	Roll, Италия

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОБИРКИ

- ***Одноразовые лабораторные пробирки без крышки, нестерильные, объем 3–5 мл***

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Произво-дитель
18054	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС	3	12×56	1000 / 6000	Roll, Италия
18026	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС для РИА	3	11×70	5000	Roll, Италия
18042	Пробирка прозрачная, с плоским дном, с отметками 1,25–2–2,5 мл, ПС	3	12×56	6000	Roll, Италия
18044	Пробирка прозрачная, с плоским дном, с этикеткой, с отметками 1,25–2–2,5 мл, ПС	3	12×56	6000	Meus, Италия
18038	Пробирка матовая, с плоским дном, с отметками 1,25–2–2,5 мл, ПП	3	12×56	6000	Roll, Италия
18040	Пробирка матовая, с плоским дном, с этикеткой, с отметками 1,25–2–2,5 мл, ПП	3	12×56	6000	Meus, Италия
18930	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с отметкой 3 мл, Sieroplast (ПММА)	4,5	13×75	4000	Roll, Италия
18932	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, с отметкой 3 мл, Sieroplast (ПММА)	4,5	13×75	4000	Meus, Италия
18060	Пробирка матовая, цилиндрическая, с отметкой 3 мл, ПП	4,5	13×75	4000	Roll, Италия
18061	Пробирка матовая, цилиндрическая, с этикеткой, с отметкой 3 мл, ПП	4,5	13×75	4000	Meus, Италия
18056	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, типа Sorwall CWI, ПС	5	12×75	4000	Roll, Италия
18300	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с отметками 2,5–5 мл, Sieroplast (ПММА)	5	12×86	4000	Roll, Италия
18302	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5 мл, Sieroplast (ПММА)	5	12×86	4000	Meus, Италия
18020	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с отметками 2,5–5 мл, ПС	5	12×86	4000	Roll, Италия

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Производитель
18021	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5 мл, ПС	5	12×86	4000	Meus, Италия
18016	Пробирка матовая, цилиндрическая, с отметками 2,5–5 мл, ПП	5	12×86	4000	Roll, Италия
18018	Пробирка матовая, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5 мл, ПП	5	12×86	4000	Meus, Италия
180301	Пробирка матовая, с плоским дном, с отметками 2,5–5 мл, ПП	5	16×58	3500	Roll, Италия
180321	Пробирка матовая, с плоским дном, с этикеткой, с отметками 2,5–5 мл, ПП	5	16×58	3500	Meus, Италия
300 000 041	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, круглое дно	5	12×77	1000	Литопласт-Мед, Беларусь

- ***Одноразовые лабораторные пробирки без крышки, нестерильные, объем 8–10 мл***

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Производитель
180221	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с отметками 2,5–5 мл, Sieroplast (ПММА)	8	16×75	2500	Roll, Италия
180241	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5 мл, Sieroplast (ПММА)	8	16×75	2500	Meus, Италия
18023	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с отметками 2,5–5 мл, ПС	8	16×75	2500	Roll, Италия
18027	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5 мл, ПС	8	16×75	2500	Meus, Италия
18022	Пробирка матовая, цилиндрическая, с отметками 2,5–5 мл, ПП, круглое дно	8	16×75	2500	Roll, Италия
18024	Пробирка матовая, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5 мл, ПП	8	16×75	2500	Meus, Италия
18000	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, Sieroplast (ПММА)	10	16×100	2000	Roll, Италия
18002	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, Sieroplast (ПММА)	10	16×100	2000	Meus, Италия
18008	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с отметками 2,5–5–10 мл, ПС	10	16×100	2000	Roll, Италия
18010	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5–10 мл, ПС	10	16×100	2000	Meus, Италия
18004	Пробирка матовая, цилиндрическая, с отметками 2,5–5–10 мл, ПП	10	16×100	2000	Roll, Италия
18006	Пробирка матовая, цилиндрическая, с этикеткой, с отметками 2,5–5–10 мл, ПП	10	16×100	2000	Meus, Италия
18304	Пробирка прозрачная, коническая, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, ПС	10	16×100	2000	Roll, Италия
18306	Пробирка прозрачная, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, ПС	10	16×100	2000	Meus, Италия

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Произво-дитель
18012	Пробирка матовая, коническая, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, ПП	10	16×100	2000	Roll, Италия
18014	Пробирка матовая, коническая, с этикеткой, с отметками 0,5–1–2,5–5–10 мл, ПП	10	16×100	2000	Meus, Италия

• *Пробки для пробирок*

Roll, Италия

Кат. №	Описание	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Изображение
18028	Пробка к пробиркам для РИО, белая	11	5000	
18165	Пробка-колпачок жёлтая для пробирок 12 мл (кат. № 18159 и № 18169)		1500	
18356	Пробка жёлтая	12	4000	
18352	Пробка зелёная	12	4000	
18082	Пробка жёлтая	16	4000	
18074	Пробка зелёная	16	4000	
180526	Пробка жёлтая с язычками	12	4000	
180522	Пробка зелёная с язычками	12	4000	
180538	Пробка жёлтая с язычками	16	4000	
180534	Пробка зелёная с язычками	16	4000	

• *Одноразовые лабораторные пробирки с завинчивающимися крышками, без градуировки*

Meus, Италия

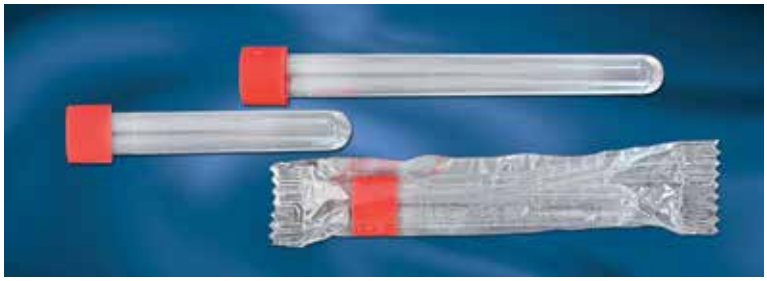

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
17040	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС	10	16×100	125 / 1000
17042	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная	10	16×100	125 / 1000
17044	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная в индивидуальной упаковке	10	16×100	750
17048	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС	16	16×120	125 / 750
17050	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная	16	16×120	125 / 750

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
17052	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная в индивидуальной упаковке	16	16×120	500
17056	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС	19	16×150	125 / 625
17058	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная	19	16×150	125 / 625
17060	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная в индивидуальной упаковке	19	16×150	500

- ***Одноразовые лабораторные пробирки с завинчивающимися крышками, с нанесенной градуировкой и местом для записи***

Meus, Италия

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
17118	Пробирка матовая, коническая, ПП	15	17×120	150 / 750
17120	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная	15	17×120	150 / 750
17122	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная в индивидуальной упаковке	15	17×120	500
17100	Пробирка матовая, коническая, ПП,	50	30×115	50 / 300
17102	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная	50	30×115	50 / 300
17104	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная в индивидуальной упаковке	50	30×115	250
17170	Пробирка матовая, коническая, ПП, с юбкой устойчивости	50	30×115	50 / 250
17172	Пробирка матовая, коническая, ПП, с юбкой устойчивости, стерильная	50	30×115	50 / 250
17174	Пробирка матовая, коническая, ПП, с юбкой устойчивости, стерильная в индивидуальной упаковке	50	30×115	200

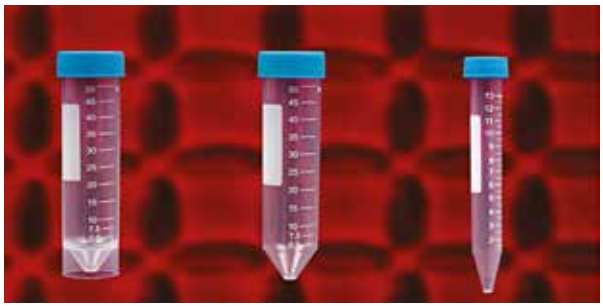

• *Одноразовые лабораторные пробирки с завинчивающимися крышками и рельефной градуировкой*

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Производитель
300 000 001	Пробирка матовая, коническая, ПП. Асептическая. Градуировка до 10 мл, шаг – 0,5. Ускорение до 12000g	10	17×99	400	Литопласт-Мед, Беларусь
300 000 001С	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная. Градуировка до 13 мл, шаг – 0,5. Ускорение до 12000g	10	17×99	400	Литопласт-Мед, Беларусь
300 000 005	Пробирка матовая, коническая, ПП. Асептическая. Градуировка до 13 мл, шаг – 0,5. Ускорение до 12000g	15	17×119	300	Литопласт-Мед, Беларусь
300 000 005С	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная. Градуировка до 13 мл, шаг – 0,5. Ускорение до 12000g	15	17×119	300	Литопласт-Мед, Беларусь
17018	Пробирка матовая, коническая, ПП	15	17×120	150 / 750	Meus, Италия
17020	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная	15	17×120	150 / 750	Meus, Италия
17022	Пробирка прозрачная, коническая, ПП, стерильная в индивидуальной упаковке	15	17×120	500	Meus, Италия
17028	Пробирка прозрачная, коническая, ПС,	15	17×120	150 / 750	Meus, Италия
17030	Пробирка прозрачная коническая, ПС, стерильная	15	17×120	150 / 750	Meus, Италия
17032	Пробирка прозрачная, коническая, ПС, стерильная в индивидуальной упаковке	15	17×120	500	Meus, Италия
17000	Пробирка матовая, коническая, ПП	50	30×115	50 / 300	Meus, Италия
17002	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная	50	30×115	50 / 300	Meus, Италия
17004	Пробирка матовая, коническая, ПП, стерильная в индивидуальной упаковке	50	30×115	250	Meus, Италия
17070	Пробирка матовая, коническая, ПП, с юбкой устойчивости	50	30×115	50 / 250	Meus, Италия
17072	Пробирка матовая, коническая, ПП, с юбкой устойчивости, стерильная	50	30×115	50 / 250	Meus, Италия
17074	Пробирка матовая, коническая, ПП, с юбкой устойчивости, стерильная в индивидуальной упаковке	50	30×115	200	Meus, Италия
300 000 024	Пробирка (тип Фалькон) матовая, коническая, ПП, с юбкой устойчивости, асептическая в индивидуальной упаковке	50	28×118	350	Литопласт-Мед, Беларусь
300 000 024С	Пробирка (тип Фалькон) матовая, коническая, ПП, с юбкой устойчивости, стерильная в индивидуальной упаковке	50	28×118	350	Литопласт-Мед, Беларусь

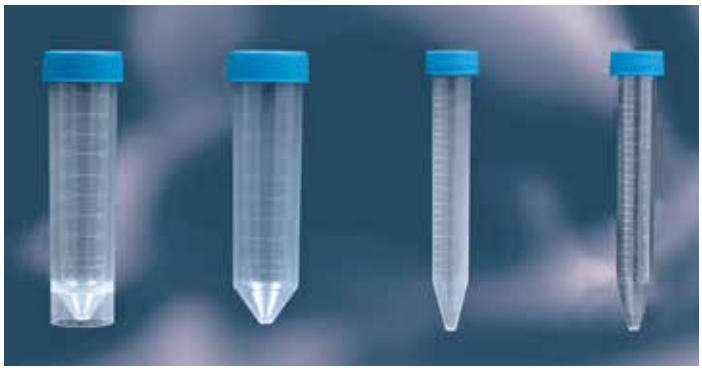

• *Одноразовые лабораторные пробирки с двухпозиционными колпачками, без градуировки*

Roll, Италия

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
17262	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП	6	12×75	250 / 1000
17266	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, стерильная	6	12×75	250 / 1000
17279	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, стерильная в индивидуальной упаковке	6	12×75	500
17223	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС	6	12×75	250 / 1000
17225	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная	6	12×75	250 / 1000
17227	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная в индивидуальной упаковке	6	12×75	500
17282	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП	14	17×100	100 / 800
17286	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, стерильная	14	17×100	100 / 800
17291	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, стерильная в индивидуальной упаковке	14	17×100	500
17243	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС	14	17×100	100 / 800
17245	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная	14	17×100	100 / 800
17249	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, стерильная в индивидуальной упаковке	14	17×100	500

Позиции колпачка-пробки

1 2 3

• *Одноразовые лабораторные пробирки с пробками*

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Произво-дитель
18307	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, с этикеткой, стерильная	5	12×86	1500	Meus, Италия
18307S	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, с этикеткой, стерильная в индивидуальной упаковке	5	12×86	1500	Meus, Италия
18417	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, с этикеткой, стерильная	5	12×86	1500	Meus, Италия
18417S	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, с этикеткой, стерильная в индивидуальной упаковке	5	12×86	1500	Meus, Италия
300 000 040	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, с отдельной пробкой, асептическая	5	12×77	800	Литопласт-Мед, Беларусь
18007	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, с этикеткой, стерильная	10	16×100	800	Meus, Италия
18007S	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, с этикеткой, стерильная в индивидуальной упаковке	10	16×100	800	Meus, Италия
18011	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, с этикеткой, стерильная	10	16×100	800	Meus, Италия
18011S	Пробирка прозрачная, цилиндрическая, ПС, с этикеткой, стерильная в индивидуальной упаковке	10	16×100	800	Meus, Италия
18015	Пробирка матовая, коническая, ПП, с этикеткой, стерильная	10	16×100	800	Meus, Италия
18015S	Пробирка матовая, коническая, ПП, с этикеткой, стерильная в индивидуальной упаковке	10	16×100	800	Meus, Италия
18303	Пробирка прозрачная, коническая, ПС, с этикеткой, стерильная	10	16×100	800	Meus, Италия
18303S	Пробирка прозрачная, коническая, ПС, с этикеткой, стерильная в индивидуальной упаковке	10	16×100	800	Meus, Италия
300 000 028	Пробирка матовая, цилиндрическая, ПП, с отдельной пробкой, асептическая	10	18×93	400	Литопласт-Мед, Беларусь

МИКРОПРОБИРКИ, КЮВЕТЫ, КАПСУЛЫ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Производитель
181645	Микропробирка тип Eppendorf, коническая, с прокалываемой крышечкой, ПП	0,75		1000/ 14000	Roll, Италия
18166	Микропробирка тип Eppendorf, коническая, с прокалываемой крышечкой, ПП	1,5		1000/ 8000	Roll, Италия
303 000 007	Микропробирка типа Eppendorf, коническая с интегрированной крышкой, с градуировкой, ПП	1,5		250	Литопласт-Мед, Беларусь
303 000 008	Микропробирка типа Eppendorf, коническая с интегрированной крышкой, с градуировкой, ПП	0,5		250	Литопласт-Мед, Беларусь
301 000 025	Кювета спектрофотометрическая, ПС	4	10×10×44	100	Литопласт-Мед, Беларусь
301 000 027	Кювета спектрофотометрическая, ПС, в штативе	4	10×10×44	100	Литопласт-Мед, Беларусь
301 000 011	Кювета спектрофотометрическая, ПС	2,5	10×10×44	100	Литопласт-Мед, Беларусь
301 000 020	Кювета спектрофотометрическая, ПС, в штативе	2,5	10×10×44	100	Литопласт-Мед, Беларусь
301 000 004	Кювета спектрофотометрическая, ПС	1,5	∅ 8,0 мм	200 / 2000	Литопласт-Мед, Беларусь
301 000 005	Кювета спектрофотометрическая, ПС, в штативе	1,5	∅ 8,0 мм	200 / 2000	Литопласт-Мед, Беларусь
301 000 029	Кювета спектрофотометрическая тип Б для коагулометров серии ACL. Блок из 20 двухотсетковых кювет (для объема пробы внутреннего отсека кюветы 1,0 мл; для объема пробы внешнего отсека кюветы 2,0 мл)			100	Литопласт-Мед, Беларусь
18320	Капсула для автоанализатора, тип Hitachi, ПС (подходит для Furuno, Сапфир)	3		1000 / 6000	Roll, Италия
18151	Капсула для автоанализатора, тип Centrifichem, ПС	0,25		1000 / 10000	Roll, Италия
18153	Капсула для автоанализатора, тип Genseac, ПС	0,5		1000 / 10000	Roll, Италия
18150	Капсула для автоанализатора, тип Technicon, ПС (подходит для JOKOH)	2		1000 / 12000	Roll, Италия
18152	Капсула для автоанализатора, тип Technicon, ПС	4		1000 / 6000	Roll, Италия
18348	Капсула для автоанализатора, тип Fibrintimer, ПС			6000	Roll, Италия

ПЛАНШЕТЫ

Roll, Италия

Кат. №	Описание	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
650111	Планшет для микротитрования на 96 лунок с U-образным дном, стерильный, в индивидуальной упаковке, ПС	50
651111	Планшет для микротитрования на 96 лунок с V-образным дном, стерильный, в индивидуальной упаковке, ПС	50
655111	Планшет для микротитрования на 96 лунок с плоским дном, стерильный, в индивидуальной упаковке, ПС	50
656111	Крышка для планшета на 96 лунок, стерильная, в индивидуальной упаковке, ПС	150
659100	Пластинка для определения групп крови на 10 ячеек	400

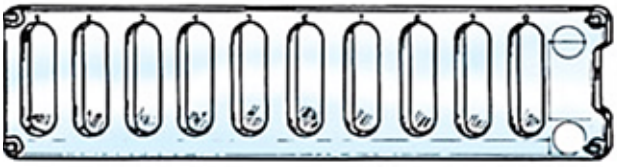

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ БИОМАТЕРИАЛОВ

- *С интегрированной лопаткой*

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Производитель
18466	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, лопатка, ПС	30	D 26 × 92	400	Meus, Италия
18476	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, лопатка, ПС, стерильный	30	D 26 × 92	400	Meus, Италия
18477	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, лопатка, ПС, стерильный в индивидуальной упаковке.	30	D 26 × 92	300	Meus, Италия
184660	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, лопатка, ПП	30	D 26 × 92	400	Meus, Италия
184760	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, лопатка , ПП, стерильный	30	D 26 × 92	400	Meus, Италия
184770	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, лопатка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	30	D 26 × 92	300	Meus, Италия
302 000 031	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, коническое дно, юбка устойчивости, лопатка, ПП, асептический.	30	D 29 × 81	700	Литопласт-Мед, Беларусь
302 000 032	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, коническое дно, юбка устойчивости, лопатка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	30	D 29 × 81	400	Литопласт-Мед, Беларусь
18125	Контейнер с плотной пробкой, этикетка, лопатка, ПС	35	D 30 x 58	450	Roll, Италия
18129	Контейнер с плотной пробкой, этикетка, лопатка, стерильный, ПС	35	D 30 x 58	450	Roll, Италия
302 000 069	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, лопатка, ПП, асептический	60	D 39 x 63	550	Литопласт-Мед, Беларусь
302 000 041	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, лопатка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке	60	D 39 x 63	350	Литопласт-Мед, Беларусь

• *Для жидких образцов*

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Производитель
18462	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, ПС	30	D 26 x 92	400	Meus, Италия
18472	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, ПС, стерильный	30	D 26 x 92	400	Meus, Италия
18473	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, ПС, стерильный в индивидуальной упаковке.	30	D 26 x 92	300	Meus, Италия
184620	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, ПП	30	D 26 x 92	400	Meus, Италия
184720	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, ПП, стерильный	30	D 26 x 92	400	Meus, Италия
184730	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, коническое дно, юбка устойчивости, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	30	D 26 x 92	300	Meus, Италия
302 000 029	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, коническое дно, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	30	D 29 x 81	400	Литопласт-Мед, Беларусь
302 000 028	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, коническое дно, ПП, асептический	30	D 29 x 81	700	Литопласт-Мед, Беларусь
184629	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, ПП	60	D 30 x 94	300	Meus, Италия
184729	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, ПП, стерильный	60	D 30 x 94	300	Meus, Италия
184739	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	60	D 30 x 94	250	Meus, Италия
302 000 040	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	60	D 39 x 63	350	Литопласт-Мед, Беларусь
302 000 018	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, ПП, асептический.	60	D 39 x 63	550	Литопласт-Мед, Беларусь
302 000 070	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	125	47 x 59 x72	200	Литопласт-Мед, Беларусь
302 000 049	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, ПП, асептический	125	47 x 59 x72	250	Литопласт-Мед, Беларусь
231173	Контейнер с отдельной винтовой крышкой, градуировка до 120 мл, матовое поле для записей, ПП	150	68 x 53 x 60	450	Roll, Италия
231176	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка до 120 мл, матовое поле для записей, бумажная этикетка, ПП	150	68 x 53 x 60	400	Roll, Италия
231178	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка до 120 мл, матовое поле для записей, бумажная этикетка, ПП, стерильный	150	68 x 53 x 60	400	Roll, Италия
231180	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка до 120 мл, матовое поле для записей, бумажная этикетка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке	150	68 x 53 x 60	350	Roll, Италия
181084	Контейнер с отдельной плотнонадеваемой крышкой, этикетка, ПС	150		480	Roll, Италия

Кат. №	Описание	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Производитель
181104	Контейнер с плотнонадеваемой крышкой, этикетка, ПС, стерильный	150		180	Roll, Италия
181114	Контейнер с плотнонадеваемой крышкой, этикетка, ПС, стерильный в индивидуальной упаковке.	150		150	Roll, Италия
231193	Контейнер с отдельной винтовой крышкой, градуировка до 170 мл, матовое поле для записей, ПП	200	93 x 53 x 60	400	Roll, Италия
231196	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка до 170 мл, матовое поле для записей, бумажная этикетка, ПП	200	93 x 53 x 60	300	Roll, Италия
231198	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка до 170 мл, матовое поле для записей, бумажная этикетка, ПП, стерильный	200	93 x 53 x 60	300	Roll, Италия
231200	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка до 170 мл, матовое поле для записей, бумажная этикетка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке	200	93 x 53 x 60	250	Roll, Италия
18102	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, ПП	200	D 60 x 80	180	Roll, Италия
18106	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, ПП, стерильный	200	D 60 x 80	180	Roll, Италия
18107	Контейнер с винтовой крышкой, этикетка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	200	D 60 x 80	140	Roll, Италия
180991	Контейнер “K-TAINER” с винтовой крышкой и маленькой пробкой, этикетка, ПП	200	D 60 x 98	135	Roll, Италия
181011	Контейнер “K-TAINER” с винтовой крышкой и маленькой пробкой, этикетка, ПП, стерильный	200	D 60 x 98	135	Roll, Италия
181091	Контейнер “K-TAINER” с винтовой крышкой и маленькой пробкой, этикетка, ПП, стерильный в индивидуальной упаковке.	200	D 60 x 98	100	Roll, Италия
302 000 077	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, асептический	250	58,9 x 112	130	Литопласт-Мед, Беларусь
302 000 076	Контейнер с винтовой крышкой, градуировка, стерильный в индивидуальной упаковке	250	58,9 x 112	120	Литопласт-Мед, Беларусь

СЧЕТНЫЕ ПЛАСТИНКИ

Roll, Италия

Кат. №	Описание	Счетная сетка	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
211710	Пластинка VETRIPLAST для микроскопии на 10 образцов		100 / 2000
212015	Пластинка PENTASQUARE для микроскопии на 10 образцов		100 / 2000

Область подсчёта представляет собой сетку, разделенную на квадраты. Исследуемая жидкость равномерно распределяется по счетной сетке таким образом, что в минимальной счетной ячейке (квадрат со стороной 0,333 мм) находится 0,0111 мкл.

Последовательность действий при подсчёте:

- После хорошего перемешивания пробы мочи налить 10 мл мочи в коническую пробирку (кат. № 18304).
- Центрифугировать мочу 5 минут при 1000–1500 об/мин.
- Слить 9 мл жидкости.
- Повторно суспендировать осадок, хорошо взболтав содержимое пробирки.
- Набрать суспензию в пипетку Пастера с капиллярным наконечником (кат. № 184358) и заполнить ячейку счётной пластинки.
- Определить общее положение счетных ячеек при 100-кратном увеличении, затем подсчитать количество частиц при 400-кратном увеличении. При 400-кратном увеличении поле считывания включает 1 маленький квадрат (0,333×0,333 мм).

Для уменьшения возможных погрешностей подсчета частиц в образце, неизбежно возникающих вследствие неравномерного распределения частиц в счётном слайде, рекомендуется проводить подсчёт в нескольких счётных квадратах.

Формулы для определения количества частиц в 1 мкл или мл исследуемой жидкости:

$$T_{\mu l} = \frac{n}{k*N*CF}, \quad T_{ml} = \frac{n*1000}{k*N*CF},$$

где n – общее количество подсчитанных частиц; k = 0,01111; N – количество маленьких квадратов, в которых производился подсчет; CF – фактор концентрации.

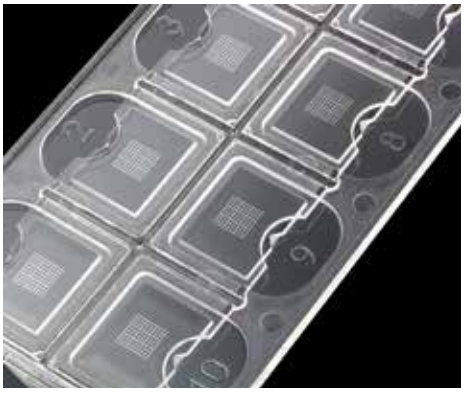

К-СЛАЙДЫ СО СРЕДАМИ

Meus, Италия

ПОГРУЖАЕМЫЕ ПЛАСТИНКИ С ДВУМЯ ИЛИ ТРЕМЯ СРЕДАМИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ПОДСЧЕТА БАКТЕРИЙ В МОЧЕ

Контейнер К-слайд представляет собой стерильный пластиковый контейнер, закрытый завинчивающейся крышкой. С внутренней стороны контейнера в его крышку интегрирована пластинка (слайд) с нанесенными, готовыми к использованию, питательными средами. Контейнер используется для исследования качества и количества микрофлоры в моче.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Отвинтить крышку и извлечь пластинку из контейнера, не касаясь поверхности со средой.
- Погрузить пластинку в мочу, так чтобы поверхности были полностью покрыты жидкостью. Достать пластинку, удалить избыток мочи, прикоснувшись нижним ребром пластинки к фильтровальной бумаге.
- Поместить пластинку обратно в контейнер и завинтить крышку. Инкубировать при +34–37°С в течение 16–24 часов.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

После инкубирования сравнить рост микроорганизмов на поверхности пластинки с Агаром CLED с приведенными ниже рисунками:

Количество бактерий

>10 000 в 1 мл

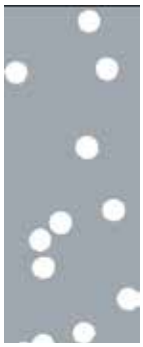

<10 000 в 1 мл

<100 000 в 1 мл

<1 000 000 в 1 мл

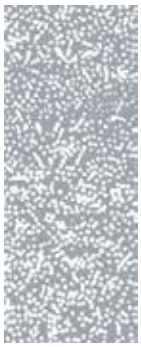

Кат. №	Описание	Минимальная упаковка, шт.
B192503	К-Слайд с двумя средами: 1 – агар Кледа; 2 – агар МакКонки. Контейнер из полипропилена	200
B192553	К-Слайд с тремя средами: 1 – агар Кледа; 2 – агар МакКонки; 3 – агар Цетримид. Контейнер из полипропилена	200
B192603	К-Слайд с тремя средами: 1 – агар Кледа; 2 – агар МакКонки; 3 – агар с желчью и эскулином. Контейнер из полипропилена	200
B192703	К-Слайд с тремя средами: 1 – агар Кледа; 2 – агар МакКонки; 3 – агар Сабуро. Контейнер из полипропилена	200
B192653	К-Слайд с тремя средами: 1 – агар Кледа; 2 – агар МакКонки; 3 – агар с экстрактом солода. Контейнер из полипропилена	200

ТУПФЕРЫ, ПРОБИРКИ С ТУПФЕРАМИ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДЫ

Meus, Италия

Кат. №	Описание	Размеры, мм.	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
23007	Тампон из вискозы на пластиковом стержне, стерильный, индивидуальная упаковка	150	100 / 2000
23021	Тампон из вискозы на алюминиевом стержне, стерильный, индивидуальная упаковка	150	100 / 500
23117	Тампон из вискозы на пластиковом стержне в ПП пробирке с этикеткой, стерильный	12×140	100 / 1800
23125	Тампон из вискозы на пластиковом стержне в ПП пробирке с этикеткой, стерильный, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 1000
23119	Тампон из вискозы на алюминиевом стержне в ПП пробирке с этикеткой, стерильный	12×140	100 / 1800
230117	Среда Стюарта в ПП пробирке. Тампон из вискозы на пластиковом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400
230507	Среда Стюарта в ПП пробирке. Тампон из вискозы на алюминиевом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400
230397	Среда Эймса в ПП пробирке. Тампон из вискозы на пластиковом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400
230417	Среда Эймса с активированным углем в ПП пробирке. Тампон из вискозы на пластиковом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400
230707	Среда Эймса в ПП пробирке. Тампон из вискозы на алюминиевом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400
230807	Среда Эймса с активированным углем в ПП пробирке. Тампон из вискозы на алюминиевом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400
230917	Среда Кэри-Блэйра в ПП пробирке. Тампон из вискозы на пластиковом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400
230197	Среда Стюарта с активированным углем в ПП пробирке. Тампон из вискозы на пластиковом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400
230607	Среда Стюарта с активированным углем в ПП пробирке. Тампон из вискозы на алюминиевом стержне. Стерильно, индивидуальная упаковка	12×140	100 / 400

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И ГАРАНТИРОВАННОГО ОТБОРА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ И НАДЕЖНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИХ В ЛАБОРАТОРИЮ

Состоят из:

- стерильных пробирок с транспортной питательной средой;
- тампонов на пластмассовых или алюминиевых стержнях.

Гарантируют жизнеспособность микроорганизмов в течение 48–72 часов, пока они не будут доставлены в лабораторию.

- ***Транспортная среда Кэри-Блэйра***

Способствует росту энтеропатогенных бактерий, в частности, *Salmonella spp.* и *Vibrio parahaemoliticus* и подавляет избыточный рост *Escherichia coli*, *Citrobacter freundi* и *Klebsiella aerogenes*.

- ***Транспортная среда Эймса с активированным углем и без него***

Эта полужидкая среда поддерживает жизнеспособность, но не рост. Забуференный физиологический раствор в среде (вместо глицерофосфата содержащегося в среде Стюарта) препятствует избыточному росту посторонней микрофлоры и способствует лучшему выделению патогенных микроорганизмов.

Данная среда обеспечивает жизнеспособность:

Стрептококков, кишечных патогенов и стафилококков		Не менее 48–72 ч
Neisseria gonorrhoeae		Не менее 48 ч
Haemophilus influenzae		
Bordetella pertussis	⇒	Не менее 12–24 ч
Gardenerella vaginalis		

Активированный уголь способствует лучшему сохранению *Neisseria gonorrhoeae* и кишечных патогенов (*Salmonella* и *Shigella*).

- ***Транспортная среда Стюарта***

Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование.

Состав среды делает возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов (хотя при этом время жизни для последних неизбежно оказывается короче, чем для других бактерий).

Данная полужидкая среда не является питательной и служит лишь для сохранения бактерий без их избыточного роста.

Присутствие активированного угля способствует лучшему сохранению *Neisseria gonorrhoeae* и кишечных патогенов (*Salmonella* и *Shigella*).

Данная среда обеспечивает жизнеспособность:

Стрептококков, кишечных патогенов и стафилококков		Не менее 48–72 ч
Neisseria gonorrhoeae		Не менее 48 ч
Haemophilus influenzae		
Bordetella pertussis	⇒	Не менее 12–24 ч
Gardenerella vaginalis		

Хранение

При 4–20°С до окончания срока годности, указанного на каждой индивидуальной упаковке.

ЧАШКИ ПЕТРИ

• *Одноразовые полистироловые*

Кат. №	Описание	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Производитель
18252	Чашка Петри, стерильная, квадратная	120×120	10 / 180	Roll, Италия
17510	Чашка Петри, стерильная со счетной сеткой, вентилируемая	∅ 65	10 / 690	Roll, Италия
18130	Чашка Петри, стерильная	∅ 60	10 / 680	Roll, Италия
304 000 007	Чашка Петри, стерильная, невентилируемая, 90 мм, упак. по 20 шт.*	∅ 81	-	Литопласт-Мед, Беларусь
304 000 012	Чашка Петри, стерильная, 90 мм, вентилируемая, упак. по 20 шт.	∅ 81	400	Литопласт-Мед, Беларусь
304 000 013	Чашка Петри, стерильная, 90 мм, вентилируемая, в индивидуальной упаковке	∅ 81	250	Литопласт-Мед, Беларусь
182480	Чашка Петри, стерильная, 90 мм, вентилируемая, подходит для автоматических анализаторов	∅ 94	24 / 720	Roll, Италия
18142	Чашка Петри, стерильная, 90 мм, вентилируемая, двухсекционная	∅ 94	24 / 600	Roll, Италия
18144	Чашка Петри, стерильная, 90 мм, вентилируемая, трёхсекционная	∅ 94	24 / 600	Roll, Италия
18245	Чашка Петри, стерильная, вентилируемая, подходит для автоматических анализаторов	∅ 100	20 / 500	Roll, Италия
18136	Чашка Петри, стерильная	∅ 120	10 / 320	Roll, Италия
18138	Чашка Петри, стерильная, вентилируемая	∅ 140	10 / 220	Roll, Италия
18140	Чашка Петри, стерильная	∅ 150	5 / 200	Roll, Италия

** Минимальный заказ - 150 000 шт.*

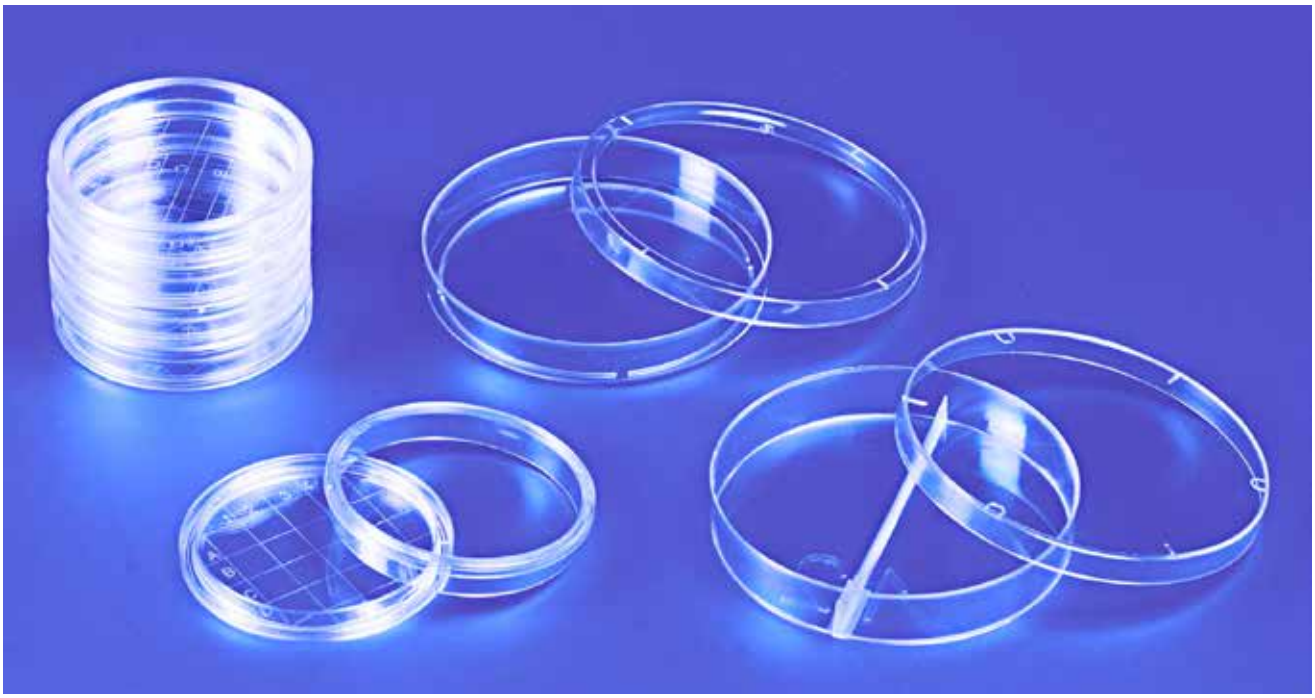

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ, ПИПЕТКИ ПАСТЕРА

Roll, Италия

Кат. №	Описание	Объем	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.
18286	Петля микробиологическая, стерильная, упак. по 20 шт.	1 мкл	20 / 8000
18288	Петля микробиологическая, стерильная, упак. по 20 шт.	10 мкл	20 / 8000
182908	Петля микробиологическая, стерильная, L-образная в индивидуальной упаковке		20 / 1000
184358	Пипетка Пастера, ПЭ, с капиллярным тонким носиком, стерильная, в индивидуальной упаковке		1000
18436	Пипетка Пастера, ПЭ, с градуировкой	1 мл	500 / 5000
184378	Пипетка Пастера, ПЭ, с градуировкой, стерильная, в индивидуальной упаковке	1 мл	1000
18432	Пипетка Пастера, ПЭ, с градуировкой	3 мл	500 / 5000
184338	Пипетка Пастера, ПЭ, с градуировкой, стерильная, в индивидуальной упаковке	3 мл	1000
184400	Пипетка Пастера, ПЭ, 125 мм, для мочевых пластинок		1000 / 10000
184408	Пипетка Пастера, ПЭ, 125 мм, для мочевых пластинок, стерильная, в индивидуальной упаковке		1000

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ

Dragonlab, Китай

Дозаторы предназначены для точного отбора и дозирования объемов жидкости в лабораторной практике.

Дозаторы рассчитаны на объемы от 0,1 мкл до 10 мл.

Все дозаторы проходят контроль качества согласно ISO8655/DIN12650. Контроль качества по ISO8655/DIN 12650 включает в себя гравиметрическое тестирование каждого дозатора с использованием дистиллированной воды (степень очистки 3, DIN ISO 3696) при 22°C и оригинальных наконечников производителя.

Каждый дозатор поставляется с индивидуальным сертификатом контроля качества.

ДОЗАТОРЫ TopPette

- Легкий вес, эргономичный дизайн, минимальное усилие для пипетирования.
- Цифровой дисплей четко показывает настройки объема дозирования.
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0,1 мкл до 10 мл.
- Простота калибровки и обслуживания входящим в комплект поставки инструментом.
- Конструкция помогает избежать травм и хронических растяжений сухожилий от повторяющихся манипуляций.
- Калибровка в соответствии с ISO8655. Каждый дозатор поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний.
- Нижняя часть может быть автоклавирована.

• *Дозаторы TopPette переменного объема*

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,1–2,5	0,05	10
0,5–10	0,1	10
5–50	0,5	200, 300, 350
2–20	0,5	200, 300
10–100	1	200, 300, 350
20–200	1	200, 300, 350
50–200	1	200, 300, 350
100–1000	5	1000
200–1000	5	1000
1000–5000	50	1000
2–10 мл	0,1 мл	1000

• *Дозаторы TopPette фиксированного объема*

Объем, мкл	Объем наконечника, мкл
5	10
10	10
20	200, 300, 350
25	200, 300, 350
50	200, 300, 350
100	200, 300, 350
200	200, 300, 350
250	1000
500	1000
1000	1000
2000	5000
5000	5000

• *8-канальные дозаторы TopPette переменного объема*

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,5–10	0,1	10
5–50	0,5	200, 300, 350
50–300	5	350

• *12-канальные дозаторы TopPette переменного объема*

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,5–10	0,1	10
5–50	0,5	200, 300, 350
50–300	5	350

ДОЗАТОРЫ MicroPette

- Эргономичный дизайн, минимальное усилие для пипетирования.
- Дисплей с большими цифрами четко показывает настройки объема дозирования.
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0,1 мкл до 10 мл.
- Простота калибровки и обслуживания входящим в комплект поставки инструментом.
- Изготовлены из инновационных материалов.
- Калибровка в соответствии с ISO 8655. Каждый дозатор поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний.
- Нижняя часть может быть автоклавирована.

• *Дозаторы MicroPette переменного объема*

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,1–2.5	0,05	10
0,5–10	0,1	10
2–20	0,5	200, 300
5–50	0,5	200, 300, 350
10–100	1	200, 300, 350
20–200	1	200, 300, 350
50–200	1	200, 300, 350
100–1000	5	1000
200–1000	5	1000
1000–5000	50	1000
2–10 мл	0,1 мл	1000

• *Дозаторы MicroPette фиксированного объема*

Объем, мкл	Объем наконечника, мкл
5	10
10	10
20	200, 300, 350
25	200, 300, 350
50	200, 300, 350
100	200, 300, 350

Объем, мкл	Объем наконечника, мкл
200	200, 300, 350
250	1000
500	1000
1000	1000
2000	5000
5000	5000

- ***8-канальные дозаторы MicroPette переменного объема***

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,5–10	0,1	10
5–50	0,5	200, 300, 350
50–300	5	350

- ***12-канальные дозаторы MicroPette переменного объема***

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,5–10	0,1	10
5–50	0,5	200, 300, 350
50–300	5	350

ДОЗАТОРЫ MicroPette Plus

- Полностью автоклавируемые.
- Эргономичный дизайн, минимальное усилие для пипетирования.
- Дисплей с большими цифрами четко показывает настройки объема дозирования.
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0,1 мкл до 10 мл.
- Простота калибровки и обслуживания входящим в комплект поставки инструментом.
- Изготовлены из инновационных материалов.
- Калибровка в соответствии с ISO 8655. Каждый дозатор поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний.

• *Дозаторы MicroPette Plus переменного объема*

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,1–2.5	0,05	10
0.5–10	0,1	10
2–20	0,5	200, 300
5–50	0,5	200, 300, 350
10–100	1	200, 300, 350
20–200	1	200, 300, 350
50–200	1	200, 300, 350
100–1000	5	1000
200–1000	5	1000
1000–5000	50	1000

• *Дозаторы MicroPette Plus фиксированного объема*

Объем, мкл	Объем наконечника, мкл
5	10
10	10
20	200, 300, 350
25	200, 300, 350
50	200, 300, 350
100	200, 300, 350
200	200, 300, 350
250	1000
500	1000
1000	1000
2000	5000
5000	5000

• *8-канальные дозаторы MicroPette Plus переменного объема*

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,5–10	0,1	10
5–50	0,5	200, 300, 350
50–300	5	350

• *12-канальные дозаторы MicroPette Plus переменного объема*

Диапазон объемов, мкл	Шаг выбора объема, мкл	Объем наконечника, мкл
0,5–10	0,1	10
5–50	0,5	200, 300, 350
50–300	5	350

ШТАТИВЫ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ

Dragonlab, Китай

Описание
Штатив Dragonlab линейный на 6 дозаторов

Описание
Штатив Dragonlab круглый на 6 дозаторов

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ

Кат. №	Описание	Объем, мкл	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Произво-дитель
18260	Наконечник тип Gilson, сплошной “универсальный”, жёлтый	200	1000 / 25000	Roll, Италия
18261	Наконечник тип Gilson, сплошной “универсальный”, жёлтый, стерильный, в упаковке по 5 шт.	200	1000	Roll, Италия
182605	Наконечник тип Gilson, сплошной “универсальный”, жёлтый в 5-уровневом штативе по 200 шт.	200	1000 / 10000	Roll, Италия
18170	Наконечник тип Eppendorf-Brand-Socorex, с “юбочкой”, жёлтый	200	1000 / 25000	Roll, Италия
18171	Наконечник тип Eppendorf-Brand-Socorex, с “юбочкой”, жёлтый, стерильный, в упаковке по 5 шт.	200	1000	Roll, Италия
181705	Наконечник тип Eppendorf-Brand-Socorex, с “юбочкой”, жёлтый в 2-уровневом штативе по 192 шт.	200	384 / 10368	Roll, Италия
18178	Наконечник тип Oxford, короткий вариант, белый	200	1000 / 25000	Roll, Италия
18187	Наконечник тип Oxford, длинный вариант, белый	200	1000 / 15000	Roll, Италия
18188	Наконечник тип Oxford, длинный вариант, белый, стериль-ный, в упаковке по 5 шт.	200	1000	Roll, Италия
305 000 006	Наконечник с фаской для дозаторов тип 1	250	500	Литопласт-Мед, Беларусь
305 000 008	Наконечник с фаской для дозаторов тип 1 в штативе	250	96	Литопласт-Мед, Беларусь

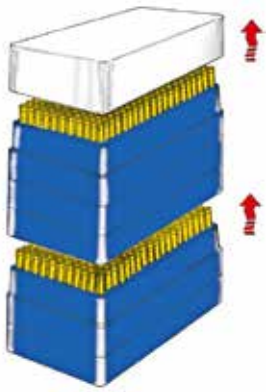

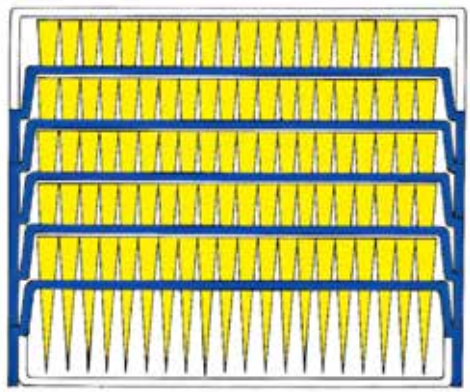

Кат. №	Описание	Объем, мкл	Кол-во шт. в упаковке, мин. / трансп.	Произво-дитель
18172	Наконечник тип Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex, с “юбочкой”, синий, “универсальный”	1000	1000 / 10000	Roll, Италия
18173	Наконечник тип Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex, с “юбочкой”, синий,“универсальный”, стерильный, в упаковке по 5 шт.	1000	1000	Roll, Италия
181727	Наконечник тип Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex, с “юбочкой”, синий, “универсальный”, в 2-уровневом штативе по 100 шт.	1000	200 / 4800	Roll, Италия
18191	Наконечник тип Oxford, синий, сплошной, нестерильный	1000	1000	Roll, Италия
305 000 007	Наконечник с фаской для дозаторов тип 2	1000	500	Литопласт-Мед, Беларусь
18266	Наконечник тип Oxford-Gilson, белый	5 мл	300 / 2400	Roll, Италия

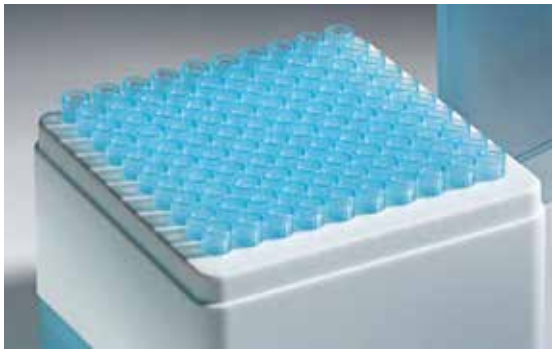

JCA-BioMajesty 6010/C
"JEOL", Япония

CA-400
"Furuno Electric Co", Япония

RESPONS®910
"DiaSys", Германия

CoaLab 1000
"Labitec", Германия

Swelab Alfa Auto Sampler
"Boule Medical A.B.", Швеция

Quintus
"Boule Medical A.B.", Швеция

Super GL
"Dr. Müller", Германия

H-500
"DIRUI", Китай

FUS-100, H-800
"DIRUI", Китай

PATHFAST®
"LSI Medience Corporation", Япония

Modular pro
"ESCHWEILER", Германия

EX-D
"JOKOH", Япония

АО «ДИАКОН», 142290, Московская обл.,
г. Пущино, ул. Грузовая, 1А
Тел.: 8 (495) 980–63–39

Телефон горячей линии: 8-800-2006-339
E-mail: sale@diakonlab.ru
www.diakonlab.ru

01.17